


房屋的溫濕度差 M0025-C02

記錄房屋的溫濕度差，從而分析空調和隔熱效果。

要點

- 在房屋各個點設置溫濕度記錄儀 LR5001。通過記錄溫濕度變化，可分析空調和隔熱的效果。
- 可讓各個溫濕度記錄儀的時間同步，並可通過電腦軟體重疊顯示圖表。

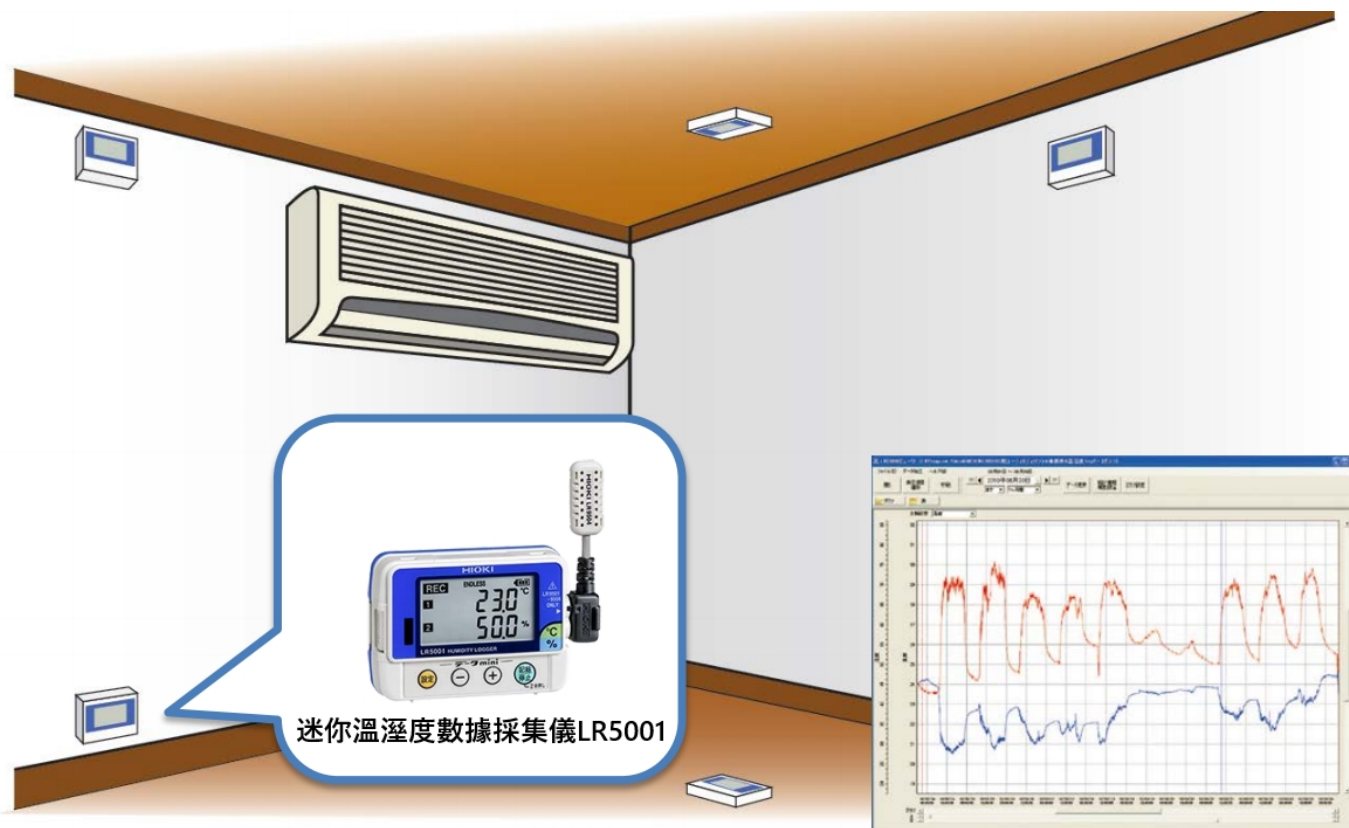

迷你溫溼度數據採集儀LR5001

- 要將數據傳輸至電腦中，需要通訊轉換器 LR5091或數據採集器LR5092-20。兩者都標配了欲於電腦的應用軟體。



數據採集器 LR5092-20 通訊轉換器 LR5091

使用儀器

迷你溫濕度數據採集儀：LR5001

通訊轉換器：LR5091

數據採集儀：LR5092-20

※記載的內容是根據 2014 年 2 月發行的儀器型號。可能在產品款式上有更改，請以現在發行的為準。